Triar els paràmetres després de substituir

Triar els paràmetres després de substituir

Context

Si les recomanacions de dosificació i temperatura difereixen entre els dos articles, s’obre una finestra després de triar la substitució.

Punt de partida

Finestra de dosificació i temperatura després de substituir

Requisits previs

- La finestra s’obre si les recomanacions difereixen entre els dos articles.

Passos

1. Conservar els valors actuals

A Deixar sense canvis, examineu la dosificació i temperatura utilitzades. Premeu-ne el botó Seleccionar si les voleu conservar.

2. Aplicar o adaptar els valors nous

A Modificar, a la dreta, examineu els valors de l’article nou. Conserveu les propostes o introduïu els vostres valors i premeu Seleccionar en aquesta secció.

3. Validar els paràmetres

Feu clic a Validar, a baix a la dreta. Els valors triats s’apliquen als procediments afectats per la substitució. Reviseu després els paràmetres i el procediment operatiu.

Resultat esperat

Els valors actuals, recomanats o introduïts s’apliquen als procediments afectats.

Recordeu

- Hi ha tres possibilitats: conservar els valors, seguir les recomanacions de l’article nou o introduir valors adequats a l’ús. Comproveu sempre les indicacions del fabricant.

Il·lustracions

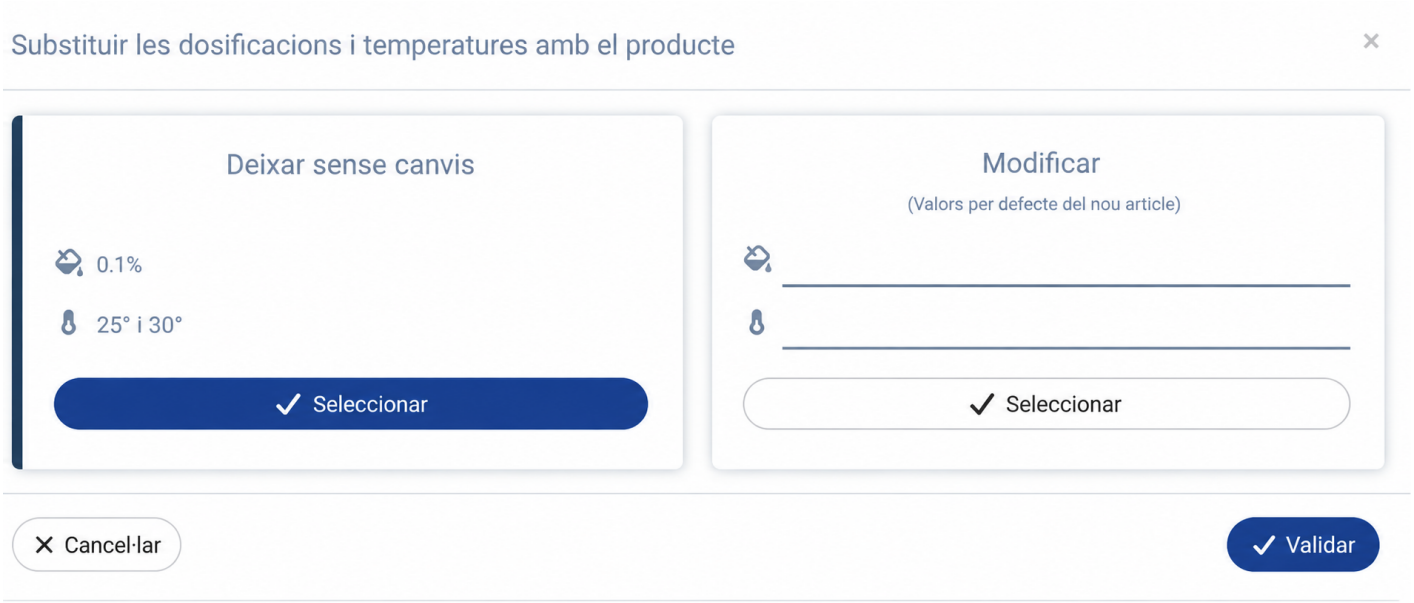

Vegeu també

- Substituir un producte en un àmbit
- Introduir els paràmetres d’un procediment

Revision #2
Created 2026-11-24 06:37:07 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 07:00:39 UTC by eCare Content Studio