Choisir les paramètres après remplacement

Choisir les paramètres après remplacement

Contexte

Si les préconisations de dosage et de température diffèrent entre les deux articles, une fenêtre s’ouvre après le choix du remplacement.

Point de départ

Fenêtre de dosage et température après remplacement

Pré-requis

- La fenêtre s’ouvre si les préconisations diffèrent entre les deux articles.

Étapes

1. Conserver les valeurs actuelles

Dans la partie Laisser inchangé, examinez le dosage et la température déjà utilisés. Cliquez sur son bouton Sélectionner si vous souhaitez les conserver.

2. Appliquer ou adapter les nouvelles valeurs

Dans la partie Modifier, à droite, examinez les valeurs du nouvel article. Conservez ces propositions ou saisissez vos propres valeurs, puis cliquez sur le bouton Sélectionner de cette partie.

3. Valider les paramètres

Cliquez sur Valider, en bas à droite. Les valeurs choisies sont appliquées à la ou aux procédures concernées par le remplacement. Relisez ensuite les paramètres et le mode opératoire.


Résultat attendu

Les valeurs actuelles, préconisées ou saisies sont appliquées aux procédures concernées.

À retenir

- Les trois possibilités sont : conserver les valeurs, suivre les préconisations du nouvel article ou saisir des valeurs adaptées à l’usage. Vérifiez toujours les indications du fabricant.

Illustrations

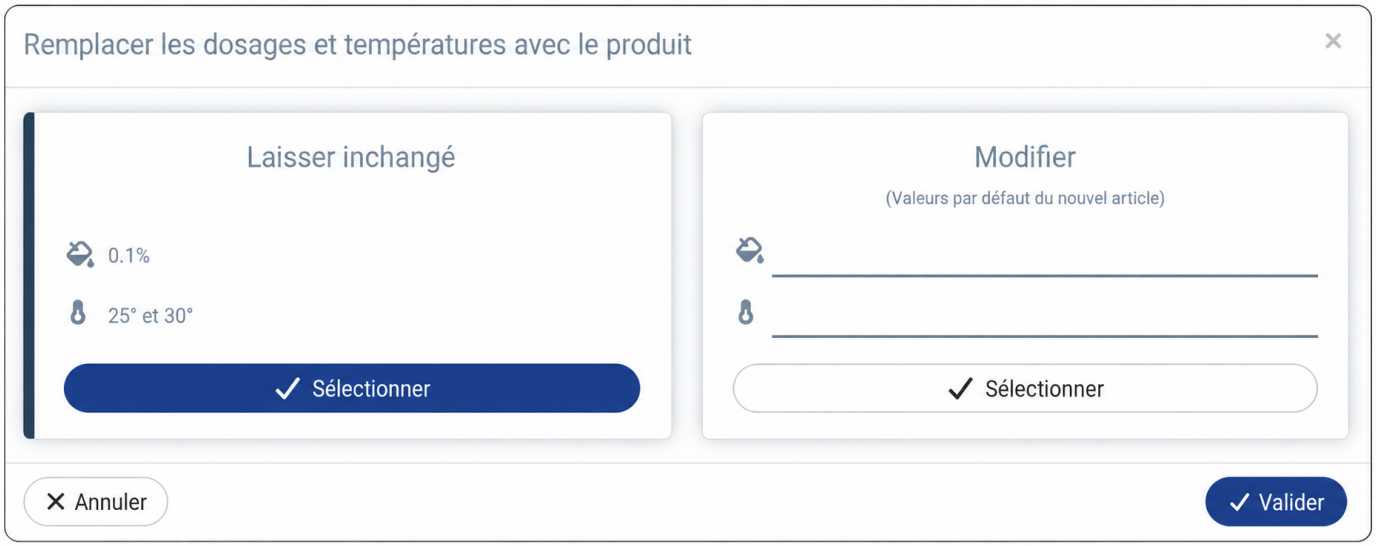

Voir aussi

- Remplacer un produit dans un périmètre
- Renseigner les paramètres d’une procédure

Revision #7
Created 2026-11-17 20:20:14 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 12:17:49 UTC by eCare Content Studio